

Milicz, 02.09.2015 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP13/2015**

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu urządzeń do laparoskopii i zabiegów endourologicznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Parametry ogólne.

Lp. 4

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w języku angielskim lub niemieckim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści instrukcji obsługi w języku angielskim lub niemieckim. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim.

PYTANIE NR 2: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Panoramiczny monitor medyczny LCD

Czy Zamawiający dopuści monitor z jednym rodzajem mocowania VESA? Monitor jest częścią zestawu ustawionego na wózku medycznym, który posiada tylko jeden rodzaj montowania monitora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie monitora z jednym rodzajem mocowania VESA.

PYTANIE NR 3: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Panoramiczny monitor medyczny LCD

Czy Zamawiający dopuści monitor o poniższych parametrach?

Matryca 27" TFT IPS LED

Wejścia sygnałowe:

1 x DVI-D 1

1 x DVI-D 2 (opcjonalnie)

1 x VGA (D-sub)

1 x SD/HD/3G-SDI (BNC)

1 x C-Video (BNC)

2 x S-Video (Y/C) (BNC)

1 x Component

GPIO port: Swap, PIP / PBP1 / PBP2 Select, Record indicator

Wyjścia sygnałowe: 1 x DVI-D, 1 x SD/HD/3G-SDI (BNC)

Klawisze funkcyjne: Power, Menu, PIP, Up, Down, Plus, Minus, Input

Jasność: min. 250 cd/m²

Czas reakcji matrycy: maks. 8 ms

Kąty widzenia (CR>10) Prawo/Lewo=178 st., Góra/Dół=178 st.

Kontrast: min. 1000:1

Możliwość montażu:

VESA 100x100

Obsługa funkcji: Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Pan, Zoom, Freeze

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie monitora medycznego o parametrach jak wyżej wymienione.

PYTANIE NR 4: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Panoramiczny monitor medyczny LCD

Czy Zamawiający dopuści monitor o poniższych parametrach?

24" TFT IPS LED

1 x DVI-D 1

1 x DVI-D 2 (opcjonalnie)

1 x VGA (D-sub)

1 x SD/HD/ (BNC)

1 x C-Video (BNC)

2 x S-Video (Y/C) (BNC)

1 x Component

Port RS 232

Wyjścia sygnałowe: 1 x DVI-D, 1 x SD/HD/3G-SDI (BNC)

Klawisze funkcyjne: Power, Menu, PIP, Up, Down, Plus, Minus, Input

Jasność: min. 400 cd/m²

Czas reakcji matrycy: maks. 6 ms

Kąty widzenia (CR>10) Prawo/Lewo=178 st., Góra/Dół=178 st.

Kontrast: min. 1000:1

Możliwość montażu:

VESA 100x100

Obsługa funkcji:

Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Pan, Zoom, Freeze

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie monitora medycznego o parametrach o parametrach jak wyżej wymienione.

PYTANIE NR 5: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Źródło światła LED-owe, Lp. 6

Czy Zamawiający dopuści źródło światła z możliwością regulacji natężenia światła za pomocą przycisków umieszczonych na głowicy kamery? Zestaw nie ma możliwości pracy bez światła, więc całkowite wyłączenie źródła światła z głowicy kamery uniemożliwia pracę całego zestawu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści źródło światła tylko jako dodatkowa opcja poza zapisami SIWZ.

PYTANIE NR 6: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Źródło światła LED-owe, Lp. 9

Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 4,8mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 4,8mm.

PYTANIE NR 7: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści optykę o dł. 340mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie optyki o dł. 340mm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 8: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści kosz do sterylizacji o dł. 460x80x55

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kosza do sterylizacji o dł. 460x80x55.

PYTANIE NR 9: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści trokar z kranem wykonanym ze stali nierdzewnej o żywotności wielokrotnie przekraczającej plastikowy element?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie trokara z kranem wykonanym ze stali nierdzewnej o żywotności wielokrotnie przekraczającej plastikowy element.

PYTANIE NR 10: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści trokar z kranem wykonanym ze stali nierdzewnej o żywotności wielokrotnie przekraczającej plastikowy element?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie trokara z kranem wykonanym ze stali nierdzewnej o żywotności wielokrotnie przekraczającej plastikowy element.

PYTANIE NR 11: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 8

Czy Zamawiający dopuści trokar z kranem wykonanym ze stali nierdzewnej o żywotności wielokrotnie przekraczającej plastikowy element?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie trokara z kranem wykonanym ze stali nierdzewnej o żywotności wielokrotnie przekraczającej plastikowy element.

PYTANIE NR 12: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 12

Prosimy o usunięcie w/w punktu w przypadku narzędzia z kranikami ze stali nierdzewnej w poz. 5 i 8 lub przypisanie ich do tych pozycji w przypadku możliwości zaoferowania obu opcji asortymentu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w punktu. Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 13: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 14

Zamawiający opisał nożyczki jako nieobrotowe, wygięte w lewo, czy Zamawiający dopuści nożyczki obrotowe Metzenbaum, wygięte, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie opisał w sposób przez Państwa cytowany wyżej wymienionych nożyczek. Zamawiający wymaga nożyczek obrotowych.

PYTANIE NR 14: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 18

Prosimy o podanie średnicy wymaganego narzędzia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Średnica 5mm.

PYTANIE NR 15: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 21

Prosimy o podanie, do jakich rodzajów klipsów (ethicon, pilling, weck, horizon czy innej firmy) zamawiający ma zamiar używać?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 16 dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe – wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 21

Czy Zamawiający dopuści rurkę o dł. 330mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rurki o długości 330mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 17: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe - wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 23

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 275x575x170[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kosza o wymiarach 275x575x170mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 18: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, instrumentarium laparoskopowe - wielorazowego użytku, autoklawowalne, Lp. 23

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 275x575x250[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kosza o wymiarach 275x575x250mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 19: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Cystoskopy, Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści cystoskop o dł. 302mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Punkt zamówienia dotyczy optyki a nie cystoskopu.

PYTANIE NR 20: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Cystoskopy, Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści cystoskop o dł. 302mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Punkt zamówienia dotyczy optyki a nie cystoskopu.

PYTANIE NR 21: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Cystoskopy, Lp. 3

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 80x460x55[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 80x460x55mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 22: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Cystoskopy, Lp. 4

Czy Zamawiający dopuści narzędzie o średnicy 17Fr, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie dotyczy płaszczka. Średnica dopuszczalna.

PYTANIE NR 23: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Cystoskopy, Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści narzędzie o średnicy 19Fr, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie dotyczy płaszczka. Średnica dopuszczalna.

PYTANIE NR 24: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Cystoskopy, Lp. 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 465x280x100[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 465x280x100mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 25: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Uretrotomy, Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści płaszcz o średnicy 21Charr, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści płaszcz o średnicy 21Charr, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 26: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Uretrotomy, Lp. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 465x280x100[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 465x280x100mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 27: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Resektoskopy, Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści płaszcz o średnicy 26Fr oraz portami niewymiennymi ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie płaszcz o średnicy 26Fr oraz portami niewymiennymi ze stali nierdzewnej.

PYTANIE NR 28: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Resektoskopy, Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści płaszcz o średnicy 26Fr oraz portami niewymiennymi ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie płaszcz o średnicy 26Fr oraz portami niewymiennymi ze stali nierdzewnej.

PYTANIE NR 29: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Resektoskopy, Lp. 3

Czy Zamawiający dopuści płaszcz o średnicy 28,5Fr oraz portami niewymiennymi ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie płaszcz o średnicy 28,5Fr oraz portami niewymiennymi ze stali nierdzewnej.

PYTANIE NR 30: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Resektoskopy, Lp. 15

Prosimy o podanie długości elektrody oraz rodzaj końcówki elektrody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Elektroda kapilarna z proponowanym resektoskopem.

PYTANIE NR 31: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Resektoskopy, Lp. 18

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 400x225x60[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 400x225x60mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 32: dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, Gwarancja i serwis, Lp. 1

Czy Wykonawca ma prawo nieuznania gwarancji obejmującej uszkodzenia mechaniczne w przypadku, gdy wykaże, że uszkodzenie nastąpiło z wyłącznej winy użytkownika, (np. upuszczenie, złamanie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Wykonawca ma prawo nieuznania gwarancji obejmującej uszkodzenia mechaniczne w przypadku, gdy wykaże, że uszkodzenie nastąpiło z wyłącznej winy użytkownika, (np. upuszczenie, złamanie).

PYTANIE NR 33: Dotyczy: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dot. Poz. 3. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LEDOWE

Pkt. 2 - Prosimy o tymczasowe dopuszczenie źródła światła ledowego o mocy odpowiadającej 180W dla źródła światła ksenon lub źródła światła ksenonowego o mocy 300W. Urządzenie to zostanie wymienione na wymagane

przez Zamawiającego źródło światła LED o mocy odpowiadającej 300 W ksenon w ciągu najbliższych kilku miesięcy, po wprowadzeniu go na rynek polski.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na tymczasowe (nie dłużej niż 3 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu) dopuszczenie źródła światła ledowego o mocy odpowiadającej 180W dla źródła światła ksenon.

PYTANIE NR 34: Dot. Poz. 7. INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Pkt 22 – Prosimy o dopuszczenie rurki ssąco-płuczającej o długości roboczej 290 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rurki ssąco-płuczającej o długości roboczej 290mm.

PYTANIE NR 35: Dot. Poz. 12– GWARANCJA I SERWIS:

Pkt 1. – Prosimy o odstąpienie od wymogu udzielenia gwarancji min. 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia **uwzględniającej wszystkie uszkodzenia łącznie z uszkodzeniami mechanicznymi**. Takie zapisy odnośnie gwarancji sprzętu endoskopowego są niespotykane w zamówieniach publicznych, teoretycznie bowiem uszkodzenia będące wynikiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub wynikające z ewidentnej winy użytkownika (upadek, złamanie) mogłyby spowodować możliwość wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z roszczeniem o naprawę gwarancyjną, co jest niezgodne z swobodą kształtowania gwarancji i zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia uwzględniającej wszystkie uszkodzenia łącznie z uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w trakcie prawidłowego użytkowania zgodnego z instrukcją oraz uwzględniającą uszkodzenia mechaniczne wynikające z wady ukrytej. Wykonawca ma prawo nieuznania gwarancji obejmującej uszkodzenia mechaniczne w przypadku, gdy wykáže, że uszkodzenie nastąpiło z wyłącznej winy użytkownika, (np. upuszczenie, złamanie).

PYTANIE NR 36:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 56 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 56 dni.

PYTANIE NR 37:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie reakcji serwisu z 48h na 72h?. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wraża zgody na wydłużenie terminu reakcji serwisu z 48h na 72h.

PYTANIE NR 38:

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, ale w przypadku ustawienia sprzętu zastępczego w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9 §5 wzoru umowy.

PYTANIE NR 39: Dot. 1 – Medyczna kamera endoskopowa Full HDTV

Ad. 1 Czy w ramach punktu 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania medyczną kamerę endoskopową współpracującą z głowicami 3 x CCD jak również z głowicami w technologii CMOS ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści medyczną kamerę endoskopową współpracującą z głowicami 3 x CCD jak również z głowicami w technologii CMOS.

PYTANIE NR 40: Dot. 1 – Medyczna kamera endoskopowa Full HDTV

Ad. 5 Czy w ramach punktu 5 Zamawiający dopuści możliwość obsługi menu kamery poprzez klawiaturę USB podłączoną do sterownika, spełniającą funkcję pilota ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość obsługi menu kamery poprzez klawiaturę USB podłączoną do sterownika, spełniającą funkcję pilota.

PYTANIE NR 41: Dot. 1 – Medyczna kamera endoskopowa Full HDTV

Ad. 7 Czy w ramach punktu 7 Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę niewymagającą do prawidłowej obsługi wyboru określonego specjalistycznego programu pracy, dzięki czemu czas na uruchomienie kamery jest krótszy oraz mniej stresujący dla personelu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści kamery niewymagającej do prawidłowej obsługi wyboru określonego specjalistycznego programu pracy, dzięki czemu czas na uruchomienie kamery jest krótszy oraz mniej stresujący dla personelu.

PYTANIE NR 42: Dot. 1 – Medyczna kamera endoskopowa Full HDTV

Ad. 12 Czy w ramach punktu 12 Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery nieautoklawowalną, która może zostać wysterylizowana przy użyciu metod gazowych niskotemperaturowych lub używana wraz z sterylnymi rękawami foliowymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści głowicy kamery nieautoklawowalnej, która może zostać wysterylizowana przy użyciu metod gazowych niskotemperaturowych lub używana wraz z sterylnymi rękawami foliowymi.

PYTANIE NR 43: Dot. 1 – Medyczna kamera endoskopowa Full HDTV

Ad. 12 Czy w ramach punktu 12 Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery pracującą w trybie automatycznej migawki w zakresie opóźnienia 1/60 - 1/17000 sek. o współczynniku sygnał / szum wynoszącym ok. 58 dB, dla której producent nie podaje informacji o współczynniku wzmocnienia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery pracującą w trybie automatycznej migawki w zakresie opóźnienia 1/60 - 1/17000 sek. o współczynniku sygnał / szum wynoszącym ok. 58 dB, dla której producent nie podaje informacji o współczynniku wzmocnienia.

PYTANIE NR 44: Dot. 2 - PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD

Ad. 1 Czy w ramach punktu 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor panoramiczny LCD o przekątnej 27" i matrycy TFT z podświetlaniem LED ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w ramach punktu 1 dopuści do zaoferowania monitor panoramiczny LCD o przekątnej 27" i matrycy TFT z podświetlaniem LED.

PYTANIE NR 45: Dot. 2 - PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD

Ad. 2 Czy w ramach punktu 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor bez wejścia Component i z jednym wejściem S-video ? Nadmieniamy, iż tego rodzaju wejścia i tak nie mają zastosowania przy współpracy z kamerami HDTV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w ramach punktu 2 dopuści do zaoferowania monitor bez wejścia Component i z jednym wejściem S-video.

PYTANIE NR 46: Dot. 2 - PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD

Ad. 3, 5, 6, 7, 10, 11 Czy w ramach punktów 3, 5, 6, 7, 10, 11 Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z gniazdem RS232 zamiast GPIO, wyposażony w funkcję PIP, PBP, POP (bez funkcji Freeze i Pan), o jasności 240 cd/m² i czasie reakcji 12 ms, obsługiwany poprzez sterownik dotykowy umieszczony na panelu przednim monitora i menu ekranowe OSD, z możliwością montażu VESA 100 x 100 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w ramach punktów 3, 5, 6, 7, 10, 11 dopuści do zaoferowania monitor z gniazdem RS232 zamiast GPIO, wyposażony w funkcję PIP, PBP, POP (bez funkcji Freeze i Pan), o jasności 240 cd/m² i czasie reakcji 12 ms, obsługiwany poprzez sterownik dotykowy umieszczony na panelu przednim monitora i menu ekranowe OSD, z możliwością montażu VESA 100 x 100.



PYTANIE NR 47: Dot. 3 - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LEDOWE

Ad. 2 Czy w ramach punktu 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła LED o mocy porównywalnej do ksenonowego źródła światła bez bezpośredniego odniesienia do jednostki mocy wyrażonej w Watach, z uwagi, iż producent nie udziela takiej informacji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania źródła światła LED o mocy porównywalnej do ksenonowego źródła światła bez bezpośredniego odniesienia do jednostki mocy wyrażonej w Watach.

PYTANIE NR 48: ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LEDOWE

Ad. 3 Czy w ramach punktu 3 Zamawiający dopuści do zaoferowania bardzo ciche źródło światła LED bez potwierdzenie głośności wyrażonej w dB, z uwagi, iż producent nie udziela takiej informacji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania bardzo ciche źródła światła LED bez potwierdzenie głośności wyrażonej w dB.

PYTANIE NR 49: ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LEDOWE

Ad. 4 Czy w ramach punktu 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania źródła światła LED z regulacją natężenia światła w zakresie 5 - 100% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania źródła światła LED z regulacją natężenia światła w zakresie 5 - 100%.

PYTANIE NR 50: ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LEDOWE

Ad. 5 Czy w ramach punktu 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania źródła światła LED o temperaturze koloru ok. 6400K ? Nadmieniamy, iż wyższe temperatury powodują nienaturalne odwzorowanie kolorów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania źródła światła LED o temperaturze koloru ok. 6400K.

PYTANIE NR 51: ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LEDOWE

Ad. 7 Czy w ramach punktu 7 Zamawiający dopuści do zaoferowania źródła światła LED bez automatycznego przejścia w tryb standby po odłączeniu światłowodu, ale z funkcją odcięcia światła zapobiegającą oślepieniu, gdy światłowód jest odłączony od źródła światła ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania źródła światła LED bez automatycznego przejścia w tryb standby po odłączeniu światłowodu, ale z funkcją odcięcia światła zapobiegającą oślepieniu, gdy światłowód jest odłączony od źródła światła.

PYTANIE NR 52: ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LEDOWE

Ad. 9 Czy w ramach punktu 9 Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o długości 2,5 m i śr. 4,8 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o długości 2,5m i śr. 4,8mm.

PYTANIE NR 53: Dot. 4 WÓZEK ENDOSKOPOWY DO ZESTAWU

Ad. 2 Czy w ramach punktu 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z 3 półkami w tym 2 regulowane ?

Odpowiedź Zamawiającego:


Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z 3 półkami w tym 2 regulowane.

PYTANIE NR 54: Dot. 4 WÓZEK ENDOSKOPOWY DO ZESTAWU

Ad. 7 Czy w ramach punktu 7 Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez dedykowanej zawieszki do światłowodu z uwagi na bezpieczeństwo światłowodu, który po zakończeniu pracy powinien zostać odłączony od źródła światła i przechowywany w szufladzie lub oddany do mycia i dezynfekcji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez dedykowanej zawieszki do światłowodu.

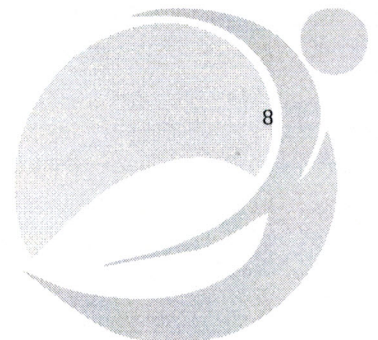

PYTANIE NR 55: Dot. 5 INSUFLATOR

Ad. 1, 2, 3, 5 Czy w ramach punktów 1, 2, 3, 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator o ciśnieniu 0 -30 mmHg i przepływie 0 - 20 l/min. wraz z odpowiednim autoklawowalnym drenem insuflacyjnym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania insuflatora o ciśnieniu 0 -30 mmHg i przepływie 0 - 20 l/min. wraz z odpowiednim autoklawowalnym drenem insuflacyjnym.

PYTANIE NR 56: Dot. 5 INSUFLATOR

Ad. 4 Czy w ramach punktu 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator uniwersalny niewymagający do prawidłowej obsługi wyboru określonego programu pracy, dzięki czemu czas na uruchomienie insuflatora jest krótszy oraz mniej stresujący dla personelu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania insuflatora uniwersalnego.

PYTANIE NR 57: Dot. 6 POMPA UROLOGICZNA

Ad. 1, 2 Czy w ramach punktów 1, 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę pracującą w trybie płuczącym o wydajności przepływu 0 - 1000 ml/min. i ciśnieniu maksymalnym 1700 mmHg, nieregulowanym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania pompę pracującą w trybie płuczącym o wydajności przepływu 0 - 1000 ml/min. i ciśnieniu maksymalnym 1700 mmHg, nieregulowanym.

PYTANIE NR 58: Dot. 6 POMPA UROLOGICZNA

Ad. 1, 2 Czy w ramach punktów 1, 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę ssącą - płuczącą o wydajności płukania regulowanej w zakresie 10 - 250 ml/min. i ciśnieniu płukania regulowanym w zakresie 20 - 200 mmHg z możliwością pracy w trybie przepływu ciągłego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę ssącą - płuczącą o wydajności płukania regulowanej w zakresie 10 - 250 ml/min. i ciśnieniu płukania regulowanym w zakresie 20 - 200 mmHg z możliwością pracy w trybie przepływu ciągłego.

PYTANIE NR 59: Dot. 6 POMPA UROLOGICZNA

Ad. 3 Czy w ramach punktu 3 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę wykorzystującą dreny płuczące jednorazowego użytku ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania pompy wykorzystującą dreny płuczące jednorazowego użytku.

PYTANIE NR 60: Dot. 6 POMPA UROLOGICZNA

Ad. 4 Czy w ramach punktu 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę bez przycisku wysokiego przepływu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania pompy bez przycisku wysokiego przepływu.

PYTANIE NR 61: Dot. 6 POMPA UROLOGICZNA

Ad. 5 Czy w ramach punktu 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę z jednym wyświetlaczem słupkowym LED ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę z jednym wyświetlaczem słupkowym LED.

PYTANIE NR 62: Dot. 6 POMPA UROLOGICZNA

Ad. 5 Czy w ramach punktu 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę z ekranem LCD ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę z ekranem LCD.

PYTANIE NR 63: Dot. 6 POMPA UROLOGICZNA

Ad. 6 Czy w ramach punktu 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę bez możliwości automatycznego rozpoznawania instrumentu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania pompy bez możliwości automatycznego rozpoznawania instrumentu.

PYTANIE NR 64: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 2 Czy w ramach punktu 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52mm.

PYTANIE NR 65: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 3 Czy w ramach punktu 3 Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast opisanego trokara, bezpieczną kaniulę trokara o śr. 11 mm wkręcaną pod kontrolą wzroku, nie wymagającą do wprowadzenia użycia trokara (gwoździa) i wywierania siły osiowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania zamiast opisanego trokara, bezpieczną kaniulę trokara o śr. 11mm wkręcaną pod kontrolą wzroku, nie wymagającą do wprowadzenia użycia trokara (gwoździa) i wywierania siły osiowej.

PYTANIE NR 66: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 4 Czy w ramach punktu 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania trokar o długości i średnicy kompatybilnej z kaniulą trokara (prowadnicą) o śr. 11 mm i długości 105 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania trokar o długości i średnicy kompatybilnej z kaniulą trokara (prowadnicą) o śr. 11mm i długości 105mm.

PYTANIE NR 67: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 5, 11 Czy w ramach punktów 5, 11 Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę trokara (prowadnicę) o śr. 11mm i dł. 105 mm ze ściętą końcówką, z wentylem klapkowym i wymiennymi kranikami metalowymi, wraz z oddzielną tuleją gwintowaną oraz kompatybilnymi uszczelkami zamiennymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę trokara (prowadnicę) o śr. 11mm i dł. 105mm ze ściętą końcówką, z wentylem klapkowym i wymiennymi kranikami metalowymi, wraz z oddzielną tuleją gwintowaną oraz kompatybilnymi uszczelkami zamiennymi.

PYTANIE NR 68: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 6 Czy w ramach punktu 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania trokar o długości i średnicy kompatybilnej z kaniulą trokara (prowadnicą) o śr. 6 mm i długości 105 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania trokar o długości i średnicy kompatybilnej z kaniulą trokara (prowadnicą) o śr. 6mm i długości 105mm.

PYTANIE NR 68: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 7 Czy w ramach punktu 7 Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast opisanego trokara, bezpieczną kaniulę trokara o śr. 6 mm wkręcaną pod kontrolą wzroku, nie wymagającą do wprowadzenia użycia trokara (gwoździa) i wywierania siły osiowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast opisanego trokara, bezpieczną kaniulę trokara o śr. 6mm wkręcaną pod kontrolą wzroku, nie wymagającą do wprowadzenia użycia trokara (gwoździa) i wywierania siły osiowej.

PYTANIE NR 70: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

AUTOKLAWOWALNE

Ad. 8, 10 Czy w ramach punktów 8, 10 Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę trokara (prowadnicę) o śr. 6 mm i dł. 105 mm ze ściętą końcówką, z wentylem klapkowym i wymiennymi kranikami metalowymi, wraz z oddzielną tuleją gwintowaną oraz kompatybilnymi uszczelkami zamiennymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę trokara (prowadnicę) o śr. 6mm i dł. 105mm ze ściętą końcówką, z wentylem klapkowym i wymiennymi kranikami metalowymi, wraz z oddzielną tuleją gwintowaną oraz kompatybilnymi uszczelkami zamiennymi.

PYTANIE NR 71: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

AUTOKLAWOWALNE

Ad. 9 Czy w ramach punktu 9 Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę Veressa o długości 130mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę Veressa o długości 130mm.

PYTANIE NR 72: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

AUTOKLAWOWALNE

Ad. 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kraniki metalowe ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania kraniki metalowe.

PYTANIE NR 73: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

AUTOKLAWOWALNE

Ad. 13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania odpowiednią do oferowanych trokarów redukcję 11 / 5 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania odpowiednią do oferowanych trokarów redukcję 11 / 5mm.

PYTANIE NR 74: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

AUTOKLAWOWALNE

Ad. 14. Czy w ramach punktu 14 Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki o długości 360 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki o długości 360mm.

PYTANIE NR 75: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

AUTOKLAWOWALNE

Ad. 15. Czy w ramach punktu 15 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny instrument Kelly do chwytania i disekcji o długości 360 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania równoważny instrument Kelly do chwytania i disekcji o długości 360mm.

PYTANIE NR 76: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

AUTOKLAWOWALNE

Ad. 16. Czy w ramach punktu 16 Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze o długości 360 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze o długości 360mm.

PYTANIE NR 77: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

AUTOKLAWOWALNE

Ad. 17. Czy w ramach punktu 17 Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzie o długości 360 mm i śr. 5 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzie o długości 360 mm i śr. 5mm.

PYTANIE NR 78: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 19, 20 Czy w ramach punktów 19, 20 Zamawiający dopuści do zaoferowania trzymadło do igieł z wkładem z węgliku wolframu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania trzymadło do igieł z wkładem z węgliku wolframu.

PYTANIE NR 79: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 22 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rurkę ssąco - płuczącą o długości 360 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania rurkę ssąco - płuczącą o długości 360mm.

PYTANIE NR 80: Dot. 7 INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Ad. 23 Czy w ramach punktu 23 Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik plastikowy do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów złożony z pokrywy przezroczystej, wkładu na instrumenty oraz wanny wyłożonej matą silikonową typu "jeż", o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 585 x 255 x 145 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik plastikowy do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów złożony z pokrywy przezroczystej, wkładu na instrumenty oraz wanny wyłożonej matą silikonową typu "jeż", o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 585 x 255 x 145mm.

PYTANIE NR 81: Dot. 8 CYSTOSKOPI

Ad. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści optykę o długości 300 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania optykę o długości 300mm.

PYTANIE NR 82: Dot. 8 CYSTOSKOPI

Ad. 3 Czy w ramach punktu 3 Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52mm.

PYTANIE NR 83: Dot. 8 CYSTOSKOPI

Ad. 4 Czy w ramach punktu 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz o rozmiarze 17 Fr ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz o rozmiarze 17 Fr.

PYTANIE NR 84: Dot. 8 CYSTOSKOPI

Ad. 5 Czy w ramach punktu 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz o rozmiarze 19 Fr ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz o rozmiarze 19 Fr.

PYTANIE NR 85: Dot. 8 CYSTOSKOPI

Ad. 7 Czy w ramach punktu 7 Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze jednoczęściowe, nieobrotowe o rozmiarze 5 Fr i długości 400 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania kleszczy jednoczęściowych, nieobrotowych o rozmiarze 5 Fr i długości 400mm.

PYTANIE NR 86: Dot. 8 CYSTOSKOPI

Ad. 8 Czy w ramach punktu 8 Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70mm.

PYTANIE NR 87: Dot. 9 URETROTOMY

Ad. 1, 2 Czy w ramach punktów 1, 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz o rozmiarze 21 Fr., z kranikami odpływowym i dopływowym, z prostą końcówką i zapięciem obrotowym do elementu pracującego wraz z kompatybilnym obturatorem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz o rozmiarze 21 Fr., z kranikami odpływowym i dopływowym, z prostą końcówką i zapięciem obrotowym do elementu pracującego wraz z kompatybilnym obturatorem.

PYTANIE NR 88: Dot. 9 URETROTOMY

Ad. 4 Czy w ramach punktu 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania nóż prosty, metalowy typu SACHSE ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania nóż prosty, metalowy typu SACHSE.

PYTANIE NR 89: Dot. 9 URETROTOMY

Ad. 5 Czy w ramach punktu 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania uretrotom OTIS o długości 160 mm i standardowym rozmiarze, bez wymiennych końcówek, wraz z dwoma wymiennymi nożami ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania uretrotom OTIS o długości 160 mm i standardowym rozmiarze, bez wymiennych końcówek, wraz z dwoma wymiennymi nożami.

PYTANIE NR 90: Dot. 9 URETROTOMY

Ad. 6 Czy w ramach punktu 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70mm.

PYTANIE NR 91: Dot. 10 RESEKTOSKOPY

Ad. 1, 2, 5 Czy w ramach punktów 1, 2, 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz resektoskopowy przepływowy, obrotowy o rozmiarze zewnętrznym 26 Fr. / 24 Fr., składający się z płaszcz zewnętrznego i wewnętrznego, wyposażony w otwory irygacyjne z przyłączami dopływu i odpływu z wymiennymi kranikami regulacji przepływu, wraz z kompatybilnym obturatorem i kompatybilnymi elektrodami w rodzajach i ilościach określonych w SIWZ w punktach 9, 11, 12, 13, 15 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania płaszcz resektoskopowego przepływowego, obrotowego o rozmiarze zewnętrznym 26 Fr. / 24 Fr., składającym się z płaszcz zewnętrznego i wewnętrznego, wyposażonego w otwory irygacyjne z przyłączami dopływu i odpływu z wymiennymi kranikami regulacji przepływu, wraz z kompatybilnym obturatorem i kompatybilnymi elektrodami w rodzajach i ilościach określonych w SIWZ w punktach 9, 11, 12, 13, 15.

PYTANIE NR 92: Dot. 10 RESEKTOSKOPY

Ad. 3, 4, 6 Czy w ramach punktów 3, 4, 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz resektoskopowy przepływowy, obrotowy o rozmiarze zewnętrznym 26 Fr. / 24 Fr., składający się z płaszcz zewnętrznego i wewnętrznego, wyposażony w otwory irygacyjne z przyłączami dopływu i odpływu z wymiennymi kranikami regulacji przepływu, wraz z kompatybilnym obturatorem i kompatybilnymi elektrodami w rodzajach i ilościach określonych w SIWZ w punktach 10, 11, 14, 15 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w ramach punktów 3,4,6 dopuści do zaoferowania płaszcz resektoskopowy przepływowy, obrotowy o rozmiarze zewnętrznym 26 Fr. / 24 Fr., składający się z płaszcz zewnętrznego i wewnętrznego, wyposażony w otwory irygacyjne z przyłączami dopływu i odpływu z wymiennymi kranikami regulacji przepływu, wraz z kompatybilnym obturatorem i kompatybilnymi elektrodami w rodzajach i ilościach określonych w SIWZ w punktach 10, 11, 14, 15.

PYTANIE NR 93: Dot. 10 RESEKTOSKOPI

Ad. 7 Czy w ramach punktu 7 Zamawiający dopuści do zaoferowania napęd roboczy monopolarny z zamkniętymi uchwytami na palce ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania napęd roboczy monopolarny z zamkniętymi uchwytami na palce.

PYTANIE NR 94: Dot. 10 RESEKTOSKOPI

Ad. 8 Czy w ramach punktu 8 Zamawiający dopuści do zaoferowania napęd roboczy bipolarny bez możliwości pracy w trybie monopolarnym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania napęd roboczy bipolarny bez możliwości pracy w trybie monopolarnym.

PYTANIE NR 95: Dot. 10 RESEKTOSKOPI

Ad. 18 Czy w ramach punktu 18 Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach zewn. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70mm.

PYTANIE NR 96: Dot. 10 RESEKTOSKOPI

Ad. 19 Czy w ramach punktu 19 Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę z adapterem sztywnym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę z adapterem sztywnym.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 07.09.2015 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

Dyrektor ds. finansowych / Główny Księgowy
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Anita Poświatowska